

农学院实验室安全检查通报

2021 年第 3 期

2021 年 5 月 9 日

5 月 9 日，共发现农学院实验室 40 处安全隐患，5 月 15 日至 5 月 30 日之间教育部将来校检查，请各课题组做好检查准备，现将本次检查情况通报如下：

一、 总体情况

5 月 9 日，农学院安全组检查发现的问题主要集中在危化品管理、个人防护等方面，具体如下：

1. 危化品台账记录不完整，账物不符合，易制毒、易制爆登记本在行政楼 A217 领取；
2. 危化品放置不符合规范，如：易燃、易制毒、易制爆药品混放，请各实验室针对危化品目录进行危化品归类；固体药品叠放；易制毒、易燃、易制爆的药品使用后，未及时放回危化品柜；
3. 实验室内一定要有消防设施，灭火器要放在显眼的位置，请自备盛放灭火器的架子；
4. 实验室内请专门规划出实验室废弃物存放区，要用黄色胶带规划出相应的区域；
5. 实验室废弃物收集处置不规范，如废液桶、废胶桶未张贴标签；废胶桶未盖等；
6. 废液桶下面要有托盘，防止废液外漏；
7. 实验室内禁止使用插线板；
8. 请放置在公共区域的仪器，一定要贴上实验室与基地处配发的标签；
9. 个人防护不规范，如学生做实验时未穿实验服、男生穿短裤、女生穿裙子等；
10. 特种设备如灭菌锅使用登记不规范，部分灭菌锅未办理使用登记证；

11. 实验垃圾未进行分类，实验室垃圾袋未使用黄色垃圾袋；
12. 实验室内禁止饮食。

请各课题组于**5月13**日前完成整改。

二、部分现场问题照



生科楼 B3001, 负责人: 丁承强;
未穿实验服



生科楼 B3006, 负责人: 刘正辉
未穿实验服




生科楼 B3004, 负责人: 李刚华
药品叠放



逸夫楼 5045, 负责人: 李珊
废胶桶无盖无标签




理科南楼 F613, 负责人: 王吴彬
未穿实验服




理科楼 C803, 负责人: 严远鑫
安全柜钥匙未拔, 灭菌器使用未登记



理科楼 A811，负责人：马正强
实验台上放置食品，未使用实验废弃物专用垃圾袋



理科楼 A830, 负责人: 管荣展
危化品使用完毕未放入危化品柜中

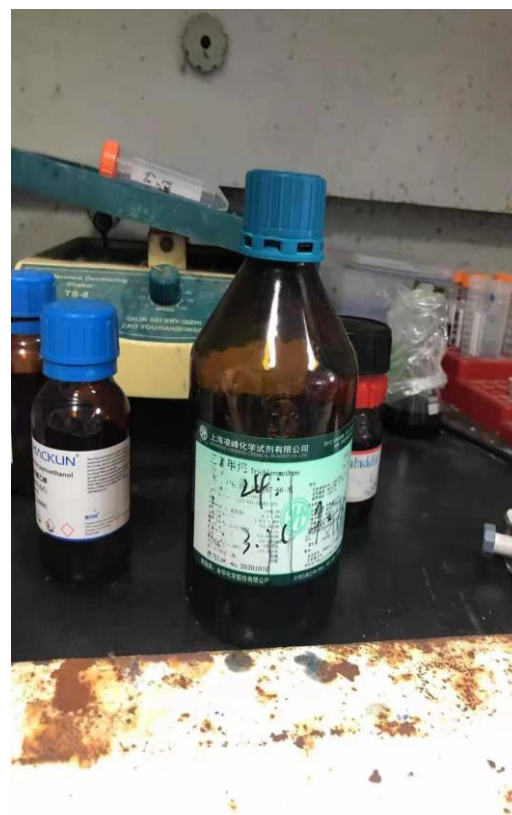

理科楼 A525, 负责人: 王益华
危化品使用完毕未放入危化品柜中




理科楼 A531, 负责人: 刘玲珑
未使用实验废弃物专用垃圾袋
实验废弃物桶未盖盖子



理科楼 A502, 负责人: 王云龙
灭菌器在用未登记




理科楼 A527, 负责人: 杨冰
试剂柜未上锁



理科楼 A501，负责人：张文伟
未穿工作服，盐酸未放入危化品柜



理科楼 A405, 负责人: 郭旺珍
未穿工作服



理科楼 A301, 负责人: 邢莉萍
未使用实验废弃物垃圾袋



理科楼 A313, 负责人: 邢莉萍
实验台上放置食品



理科南楼 F510，负责人：赵团结
实验台上放置食品



理科南楼 F625, 负责人: 喻德跃
未使用实验废弃物垃圾袋